

标准配置及选配件 Standard Configuration and Optional

标准配置 Standard Configuration

- 试样电源控制端子
- 压缩机超压保护装置
- 压缩机过热保护装置
- 2个 $\phi 80$ 的测试孔
- 带电热膜的观察窗保证视线清晰
- 不锈钢内箱和喷塑Situoma标准色外箱
- 自诊断功能报警器发现并协助解决问题
- 蒸发压力调节装置（防止湿热试验时蒸发器结冰）
- 排气压力调节装置（防止压缩机运行时压力过高）
- 冷凝压力调节装置（水冷型为了适应冬夏不同环境）
- 带有独特断热功能的门封条和测试孔减少凝露和结霜
- 门上的接水盘防止箱门打开时门上的水珠滴落
- 接地、漏电保护
- 过载及短路保护
- 循环风机过热保护
- 声光报警提示功能
- 加湿器防干烧保护装置
- 控制器温湿度自整定功能
- 总电源相序及断相保护装置
- 可调式超温保护装置（超温保护1）
- 控制器设置超温保护（超温保护2）
- 控制器锁屏功能（有效防止误操作）
- 冷却水供水欠压保护装置（水冷型）
- 空气调节通道安装超温保护（超温保护2）

选配件 Optional

- 湿热试验箱纯水自动供应装置(图1)
- 远程控制及数据传输用通讯接口和软件(图2)
- 空气干燥机(图3)
- 低湿、超低湿系统(可长时间运行超低湿 $5^{\circ}\text{C}/5\%\text{RH}$)
- 可选用不同规格的引线孔($\phi 50$ 、 $\phi 80$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 160$ 等)
- 温度记录仪（记录曲线）
- 可移动式温度传感器
- 据用户需求定制样品车
- 非标定制设备可以满足用户需求
- 特殊用途承重型样品架及承重底板

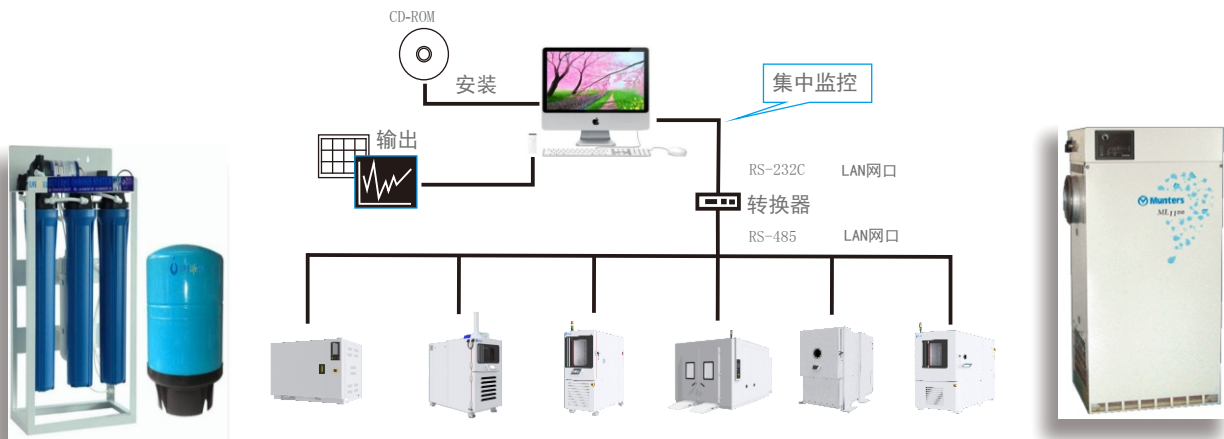


图1

图2

图3

思拓玛试验仪器（广东）有限公司

Situoma tester (Guangdong) Equipment Co.,Ltd.

东莞公司地址: 东莞市厚街镇湖景大道22号美升达市政工程工业园区

上海公司地址: 上海市虹口区物华路73号8319室

深圳公司地址: 深圳市龙岗区龙城街道盛平社区松子岭2号楼2楼

东莞公司: 0769-82686219

邮编: 523900

上海公司: 15026498108

网站: www.Situoma.com

深圳公司: 15362612832



本产品目录以实物为准
本公司保留最终解释权



WTH系列

步入式高低温湿热试验箱

Walk-in Temperature and Humidity Chamber



- 大尺寸观察窗
Large watching window

- 拼装式/整体焊接式可供选择
Assembly type/Integral welding type for choice

- 制冷机组及通道等附件采用整体式
Unitary refrigeration unit & channels

- 适合大型零部件试验样品
Suitable for large sample

- 样品电源控制端子
Synchronized power-off with the machine to protect the equipment and the test item

- 控制器自主研发
Controller developed independently

